

Maxi Move


ブレーキをかける場合、解放する場合

ブレーキをかける





保管および傾斜状態のみ。他の方法で患者を持ち上げるときは、ブレーキをかけないでください。


ブレーキを解放する

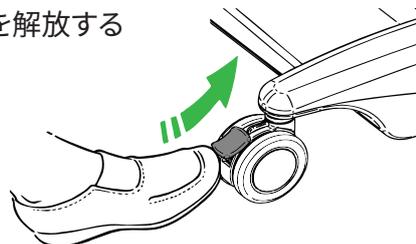


コントロールパネルとコントロールハンドセットボタン

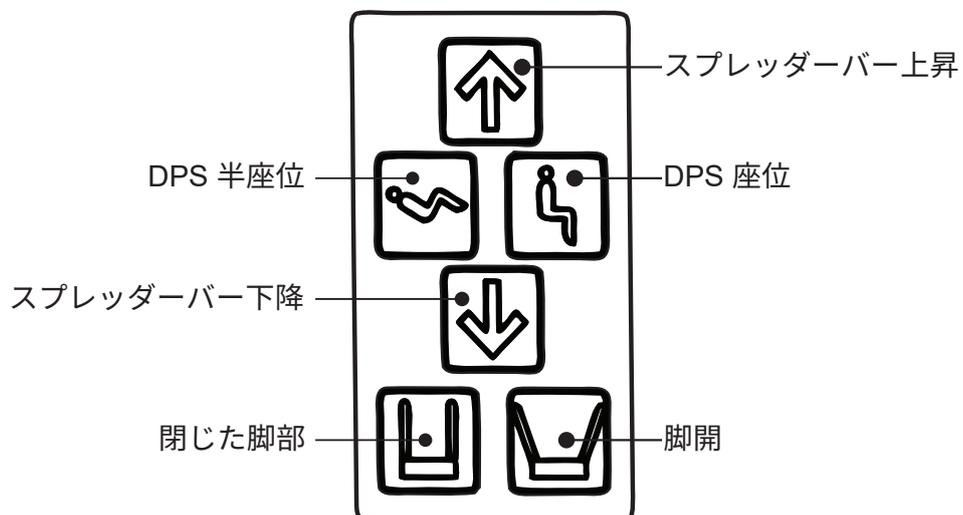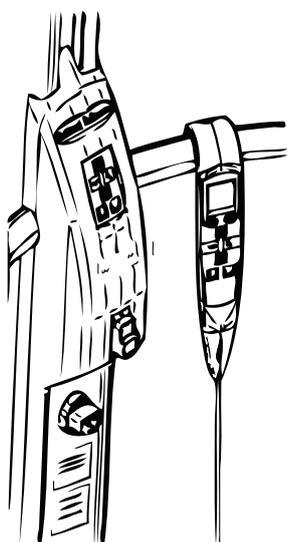

ループスリング取付具


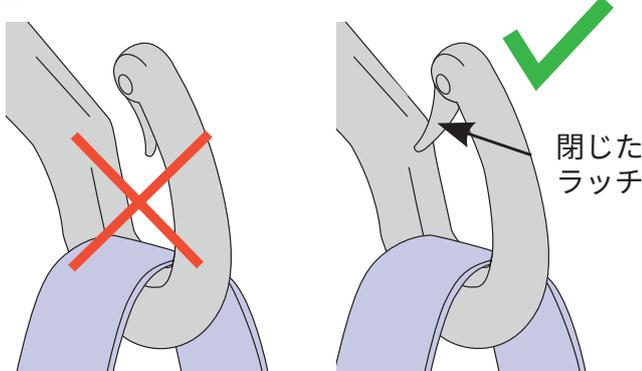


クリップスリング取付具



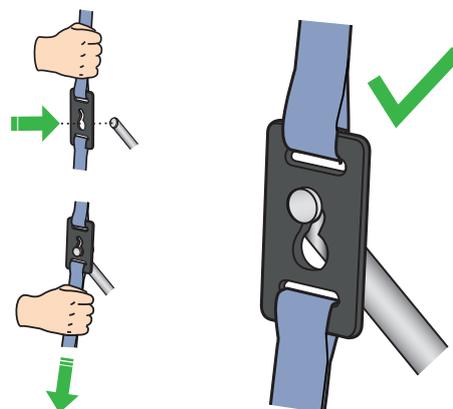


患者を持ち上げる前に、クリップをラグに取り付けて固定します。

取付具の取り外し

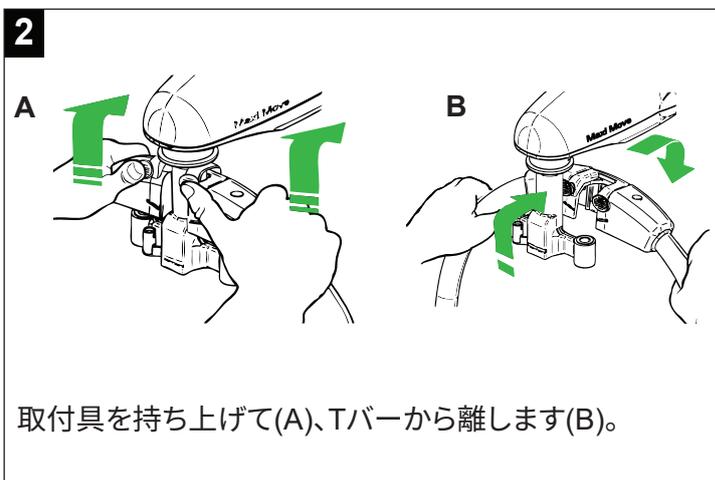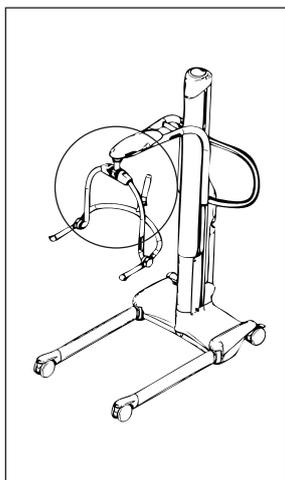

取付具の取り付け

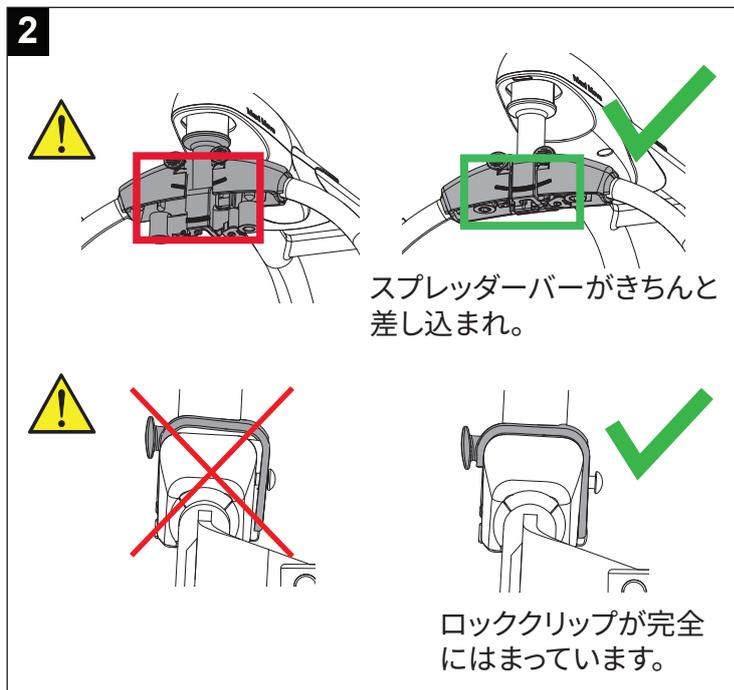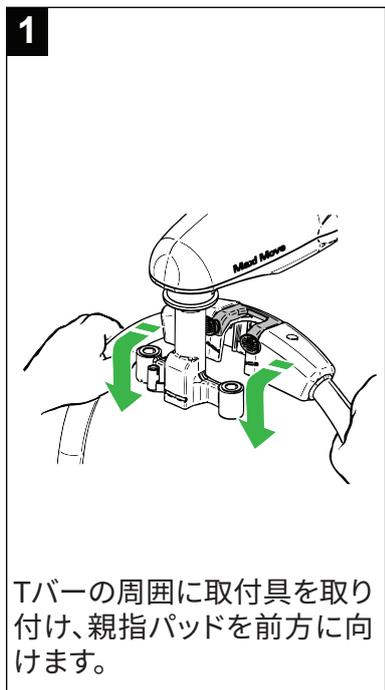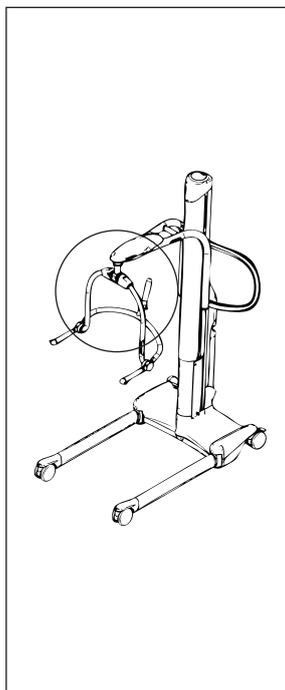

停電 - ジブを下げる

