
HITRI REFERENČNI VODNIK – FUNKCIJE

Maxi Move

CE 2797


Aktiviranje in sproščanje zavore

Aktivirajte zavoro





Samo za shranjevanje in na naklonu. Zavor ne uporabljajte pri dvigovanju bolnika na noben drug način.

Sprostite zavoro

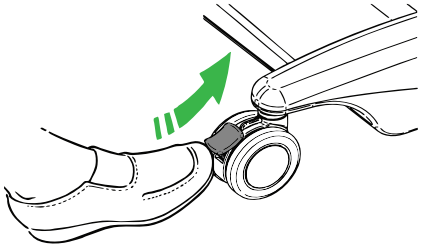


Nadzorna plošča in nadzorni gumbi upravljalnika

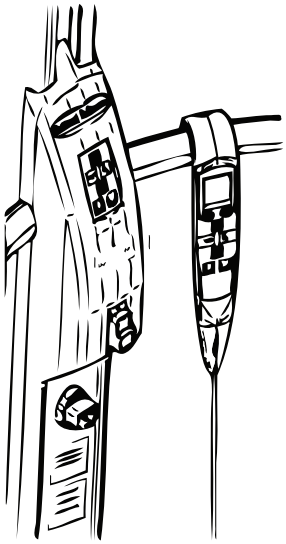


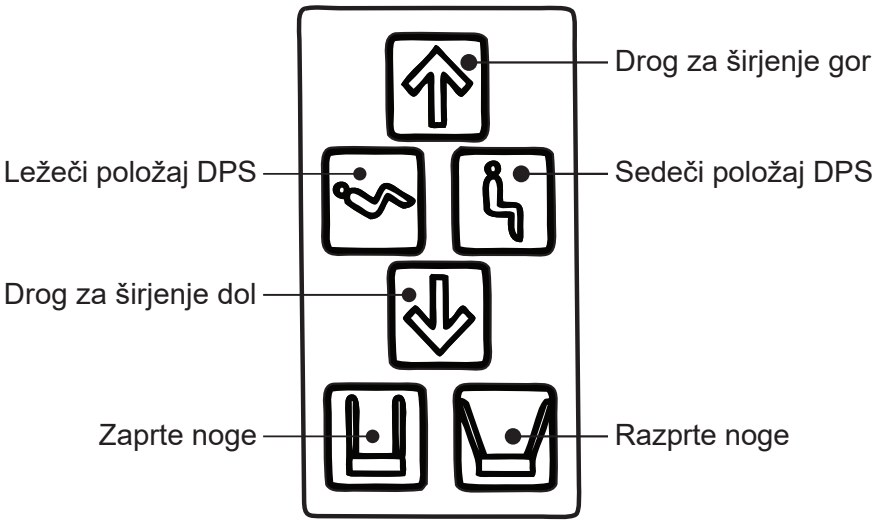

Pritrditev vreče z zanko

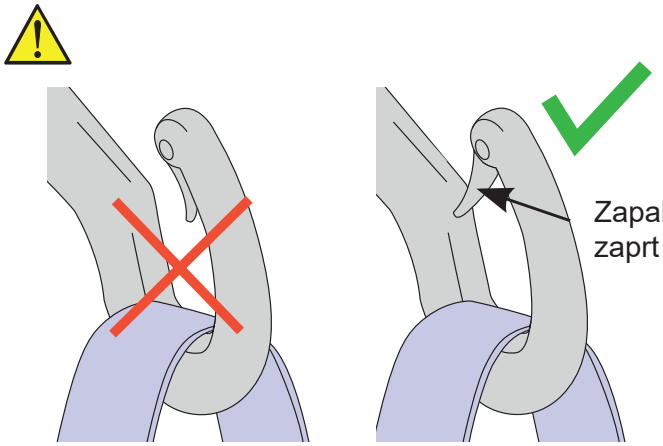


Pritrditev vreče s sponko

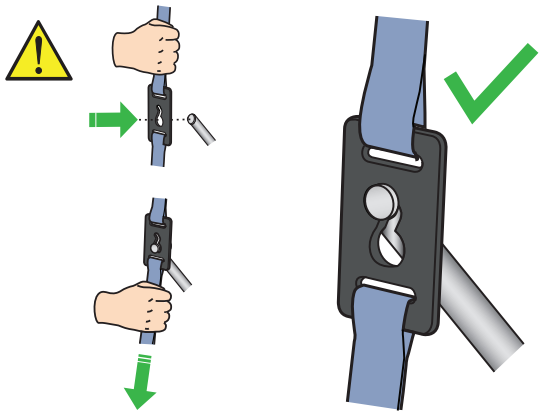


Preden dvignete bolnika, namestite in pritrdite sponko na tečaj.

arjo with people in mind

Odstranjevanje priključka

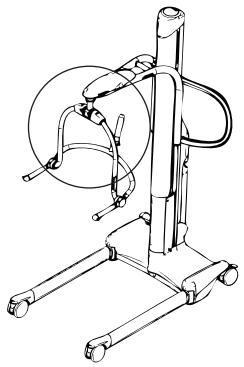


1

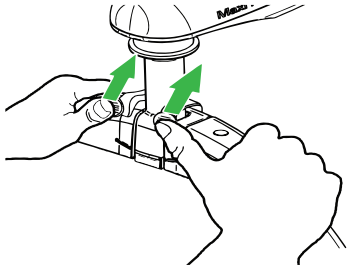


Pritisnite blazinici zaklepne sponke.

2

A

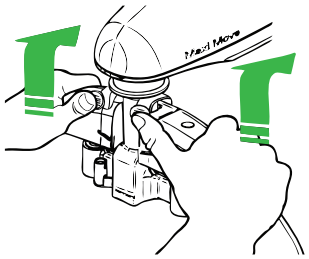


B

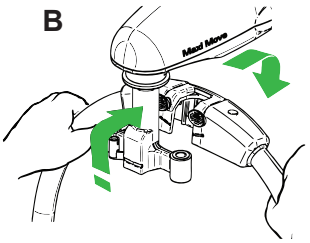


Dvignite priključek gor (A) in stran (B) od T-droga.

Nameščanje priključka

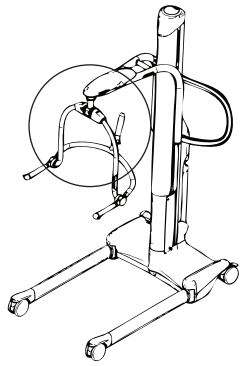



1

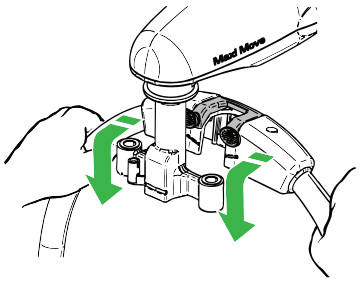


Namestite priključek okoli T-droga tako, da sta blazinici obrnjeni naprej.


2

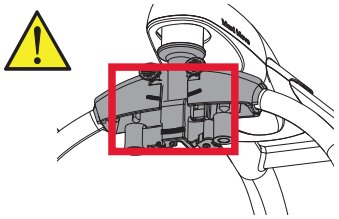

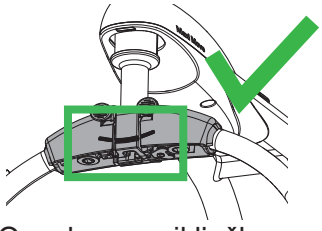


Oznake na priključku so poravnane.






Zaklepna sponka je povsem zaskočena.

Izpad električnega napajanja – spustite prečko

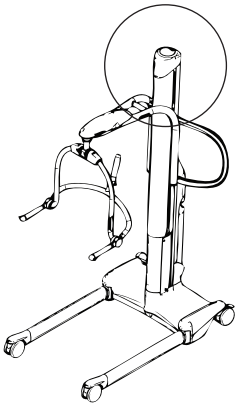


1

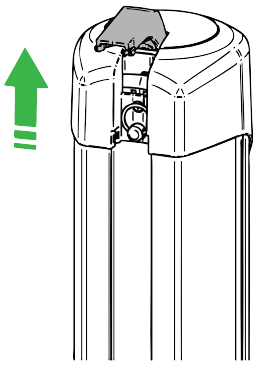


Dvignite vzvod

2

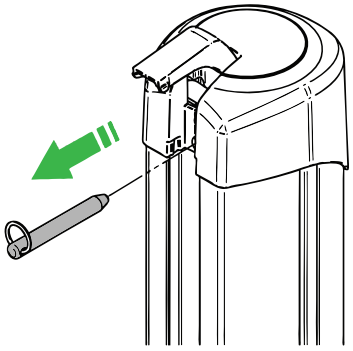

Odstranite zaklepni zatič.

3

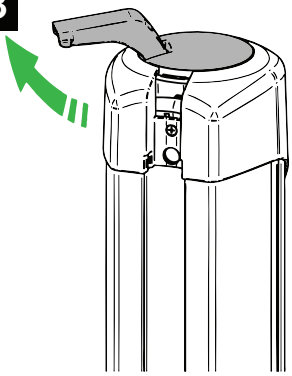

Ročico uporabite kot gonilko. Zasučite jo za en obrat v smeri urnega kazalca.