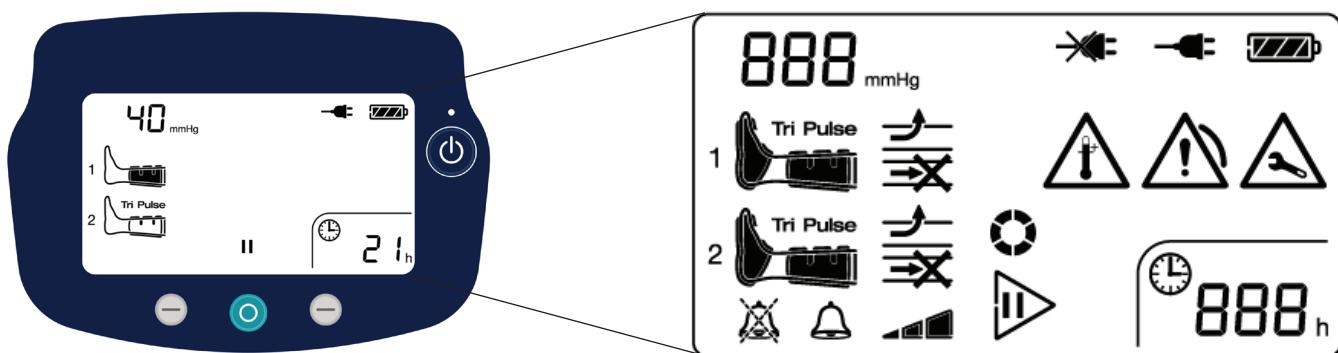


Flowtron ACS900

**Кнопка питания и индикатор питания**

Нажмите и удерживайте для перехода в режим ожидания. Индикатор питания загорится.
Нажмите и удерживайте для отключения.
Индикатор питания погаснет.

**Средняя кнопка управления**

Нажмите для запуска сеанса терапии.
Нажмите и удерживайте для остановки сеанса терапии.

**Левая кнопка управления**

Нажмите, чтобы отключить звуковой сигнал тревоги.
Нажмите и удерживайте для перехода к настройкам громкости сигнала тревоги.

**Правая кнопка управления**

Нажмите и удерживайте для входа в режим сброса таймера использования пациентом.

888 mmHg

Индикатор давления в манжете**Индикатор типа манжеты и индикатор накачивания**

Подключена, Подключена,
не накачана накачана



Ножная



Для равномерной компрессии на голень
(или голень и бедро)



Для секвенциальной компрессии на голень (Tri Pulse)
(или голень и бедро)

1
2**Номера разъемов трубки****Индикатор отключения звукового сигнала тревоги****Индикатор состояния звукового сигнала тревоги**

При сигнале тревоги: показывает, что звук сигнала тревоги можно отключить.

**Индикатор громкости****Индикация сигналов тревоги и предупреждений**

Обнаружена неисправность, которая может прервать сеанс терапии.



Низкое давление или нарушение герметичности манжеты.



Трубка перекручена или закупорена.



Высокая температура.



Обнаружена неисправность аппаратуры или требуется проведение регулярного технического обслуживания.



Ожидание — инициализация индикатора

**Индикатор начала сеанса терапии**

Отображается в режиме ожидания, если подключена хотя бы одна манжета.

**Индикатор остановки сеанса терапии**

Отображается в рабочем режиме.

**Индикаторы подключения к электросети**

Насос подключен к электрической сети.



Насос НЕ подключен к электрической сети.

**Индикатор заряда аккумулятора**

Аккумулятор разряжен

Аккумулятор заряжен на ¼

Аккумулятор заряжен на ½

Аккумулятор заряжен на ¾

Аккумулятор заряжен полностью

**Индикатор таймера использования пациентом**